

旋达®R1 物种鉴定系列

芹菜源性成分核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)

请于-20℃条件下保存, 有效期 15 个月

◆ 产品说明

旋达®R1物种鉴定系列中的过敏原鉴定试剂，可针对食品中过敏原成分的特异核酸片段进行扩增，通过实时扩增曲线判定结果。本产品用于食品及其原料中过敏原芹菜成分的检测，**检出限为 0.01%**。

◆ 产品组成 (48 测试)

| 022192M | |
|----------|--------------|
| 试剂 | 含量 |
| A-芹菜源-P | 1000μL × 1 支 |
| NG-P | 100μL × 2 支 |
| PG-芹菜源-P | 100μL × 1 支 |

◆ 适用仪器

ABI 7500、CFX 96、Mx 3005P、LineGene9600 等实时荧光 PCR 仪。

◆ 自备耗材和仪器

①冰盒；②移液器（0.5-10μL, 10-100μL, 100-1000μL）及配套灭菌吸头；③离心机；④涡旋混匀器；⑤金属浴。

◆ 注意事项

1. 本试剂检测灵敏度高。为了防止污染，实验要分区操作。

1) 第一区：试剂准备区。

2) 第二区：样本制备区。

3) 第三区：扩增及产物分析区。

★ 分区之间最好进行物理性隔离，避免人为因素造成的污染。

2. 实验过程中穿戴工作服和乳胶手套，不同区域独立使用工具，需更换手套和实验服。

3. 严格按照操作步骤操作，试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。

4. 反应液中的成分对光敏感，应避光保存。试剂使用前要完全解冻，但应避免反复冻融，推荐使用前离心 30 秒，并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。

5. 反应结束后，扩增管请置于密封袋内丢弃，当日清理，开盖易造成气溶胶污染，禁止开盖。

6. 不同批号试剂请勿混合使用，在有效期内使用。

◆ 样品处理

参照《SN/T 1961.15-2013 出口食品过敏原成分检测 第 15 部分：实时荧光 PCR 方法检测芹菜成分》或其他标准处理样品，制备的样本保存待用。

称取约 200g 样品，用洁净研钵或合适的粉碎装置将样品粉碎至粉末状用以提取 DNA。

样品的采集和制备是过敏原成分鉴别的主要步骤，为防止交叉污染，应使用一次性消耗品，研钵应经 160℃干烤 2 h，其他不宜干烤或高压处理的器皿应使用 1% 次氯酸钠溶液浸泡。其它防止交叉污染的措施按照 GB/T 27403 中的规定执行。

详细步骤请按照标准操作。

◆ 实验操作

1. 试剂配制（试剂准备区，放置于冰盒中进行）：

若有 N 个待检样品，则参照下表，按照 N+2 个数量计算各组分用量（N 个待检样品+1 个空白对照 NG+1 个阳性对照 PG），涡旋混匀，离心 30 秒，分装于 0.2ml PCR 管中。

| 试剂 | 使用量 |
|---------|------------|
| A-芹菜源-P | 20×(N+2)μL |

| | |
|--------|------------|
| 反应液总体积 | 20×(N+2)μL |
|--------|------------|

2.模板制备（样本制备区）

建议使用植物基因组提取试剂盒或深加工食品 DNA 提取试剂盒等商品化试剂盒，具体过程详见产品说明书。

3.添加模板（样本制备区，放置于冰盒上进行）

向步骤 1 每管反应液中分别加入 5μL 模板，顺序为 NG、待测样品模板、PG-芹菜源-P。盖好配套的 PCR 管盖后，涡旋混匀 30s，离心 1min，立即进行 PCR 扩增反应。

4.扩增反应（扩增及产物分析区）

使用荧光定量 PCR 仪，荧光基团选择 FAM，淬灭基团选择 NONE。

按下列条件设置扩增反应：

| | PCR 循环 | | | 荧光收集位点 |
|-----|--------|-------|--------|--------|
| 去污染 | 37°C | 10 分钟 | 1 个循环 | — |
| 预变性 | 95°C | 5 分钟 | 1 个循环 | — |
| 扩增 | 95°C | 15 秒 | 40 个循环 | — |
| | 60°C | 60 秒 | | ※ |

5.基线和阈值设定

基线调整取 3-15 个循环的荧光信号，阈值线应超过空白对照扩增曲线的最高点。


◆ 结果判定

检测样品 Ct 值≤35，则判定为被检样品阳性，检出过敏原芹菜成分。

检测样品 Ct 值≥40，则判定为被检样品阴性，未检出过敏原芹菜成分。

检测样品 35< Ct 值<40，则重复一次。如再次扩增后 Ct 值仍为<40，则判定为被检样品阳性，检出过敏原芹菜成分。如再次扩增后 Ct 值≥40，则判定为被检样品阴性，未检出过敏原芹菜成分。

★ NG 反应为平滑直线，PG 反应为“S”型扩增曲线，此次检测结果有效，否则无效。如重复检测结果仍为无效，请与技术支持人员联系。

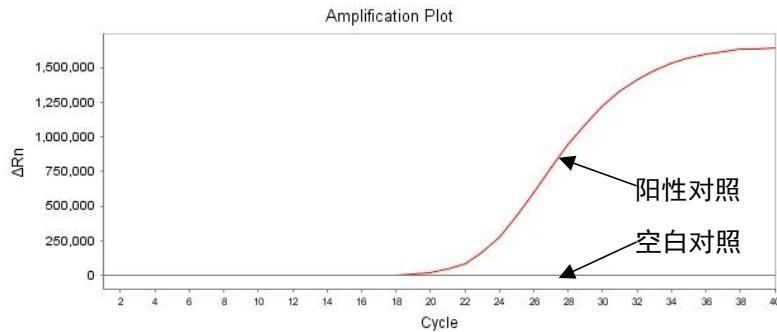

参考结果图

◆企业信息

广州双螺旋基因技术有限公司

网址: www.dhelix.cn

电话: 020-85671013

传真: 020-34037175

地址: 广州国际生物岛螺旋四路 7 号标准产业单元二期第三栋第三层 302 单元